


VITA

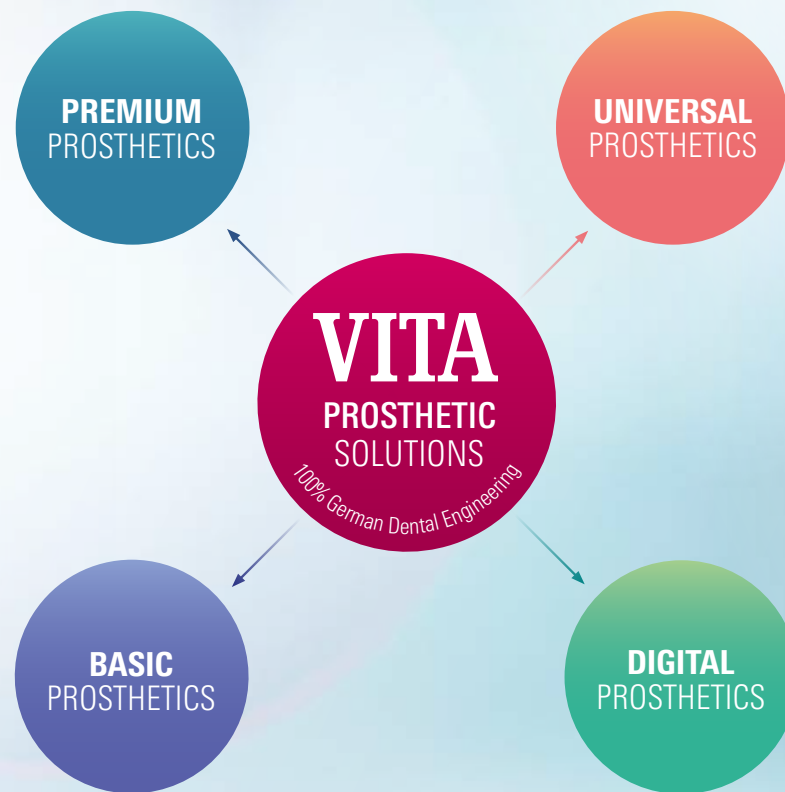

VITA PROSTHETIC SOLUTIONS

Mould Chart

Cartes de formes | Tarjeta de formas | Tabella forme

1. Select the appropriate tooth line

F: Choisissez la catégorie / gamme de dents adaptée **ES:** Seleccione la categoría/línea de dientes adecuada
I: Scegliere la categoria/linea di denti ottimale

Vivid play of shape and shade for natural results.

F: Un jeu de couleurs et de formes vivant pour des résultats naturels.

ES: Juego de formas y colores expresivo para obtener resultados naturales.

I: Vivace gioco di forme e colori per risultati naturali.

Impressive variety of shades and moulds for all cases.

F: Diversité convaincante de couleurs et de formes pour tous les cas.

ES: Variedad de colores y formas convincentes para todos los casos.

I: Poliedricità di forme e colori per tutti i casi.

Solid, standard dentures that are cost-efficient.

F: Prothèses amovibles standard solides et rentables.

ES: Prótesis estándar sólidas y rentables.

I: Solida protesi standard con un rapporto qualità-prezzo ottimale.

Efficient CAD/CAM dentures for greater productivity.

F: Prothèses CFAO efficaces pour une plus grande productivité.

ES: Prótesis CAD/CAM eficiente para aumentar la productividad.

I: Efficiente protesi CAD/CAM per una maggiore produttività.



MRP composite



MRP composite




HC polymer



> Recommended anterior / posterior combinations

F: Combinaisons antérieures / postérieures recommandées **ES:** Combinaciones de anteriores/posteriores recomendadas
I: Combinazioni anteriori/posteriori raccomandate

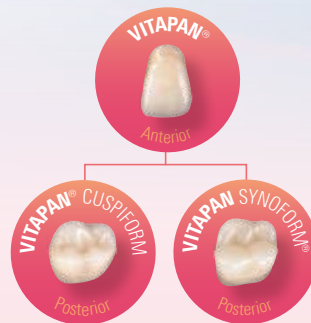

> **Recommended indication(s)***
F: Indication(s) conseillée(s)*
 ES: Indicaciones recomendadas*
 I: Indicazioni raccomandate*

	PREMIUM		UNIVERSAL		BASIC	DIGITAL	
Anterior F: Antérieure ES: Anteriores I: Anteriori	VITAPAN EXCELL	VITA PHYSIODENS	VITAPAN		VITA MFT	VITA VIONIC VIGO	VITA VIONIC FRAME
Posterior F: Postérieure ES: Posteriores I: Posteriori	VITAPAN LINGOFORM	VITA PHYSIODENS	VITAPAN CUSPIFORM	VITAPAN SYNOFORM	VITA MFT	VITA VIONIC VIGO	VITA VIONIC FRAME
Full dentures F: Prothèses totales ES: Prótesis completas I: Protesi totale	●	●	●	●	●	●	●
Partial detures F: Prothèses partielles ES: Prótesis parciales I: Protesi parziale	●	●	●		●		●
Hybrid dentures F: Prothèses combinées ES: Prótesis combinadas I: Protesi combinata	●	○	●		○		
Implant-retained dentures F: Prothèses implantoportées ES: Prótesis implantosoportadas I: Protesi implantare	●	○	○		○		
Geronto-prosthetics F: Prothèses gérontologiques ES: Prótesis gerontológica I: Gerontoprosesi				●			


● ○ **Recommended**
F: Conseillée
 ES: Recomendadas
 I: Raccomandate

* the entire spectrum of full/partial/combination and implant prostheses are typically possible
 F: toutefois l'ensemble des prothèses totales, partielles, combinées et implanto-portées est généralement possible
 ES: bien por regla general puede realizarse todo tipo de prótesis completas, parciales, combinadas e implantosoportadas
 I: realizzabile l'intera gamma di protesi totali, parziali, combinate e implantari!

VITAPAN EXCELL	VITAPAN LINGOFORM	VITA PHYSIODENS	VITAPAN	VITAPAN CUSPIFORM	VITAPAN SYNOFORM	VITA MFT	VITA VIONIC VIGO	VITA VIONIC FRAME
-------------------	----------------------	--------------------	---------	----------------------	---------------------	-------------	---------------------	----------------------


2. Select the appropriate mould group

F: Choisissez le groupe de formes adapté **ES:** Seleccione el grupo de formas adecuado **I:** Scegliere il gruppo di forme ottimale

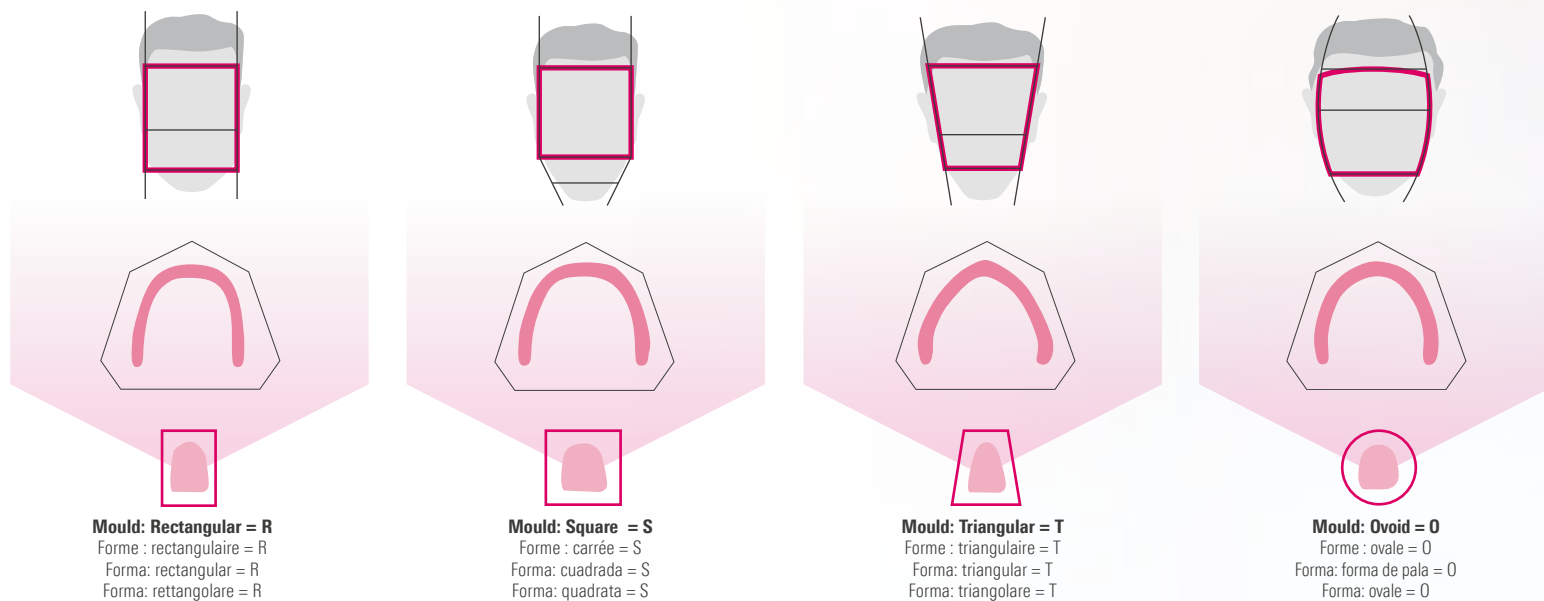


3. Determine the appropriate tooth mould

F: Déterminez la forme de dent adaptée **ES:** Determine la forma dental adecuada **I:** Stabilire la forma del dente adatta

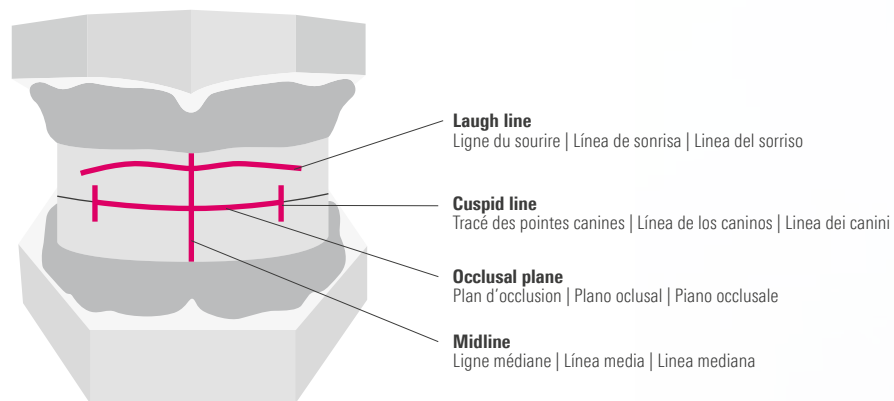

Laugh line
 Ligne du sourire | Línea de sonrisa | Linea del sorriso



Cuspid line
 Tracé des pointes canines | Línea de los caninos | Linea dei canini

Measurement points: How tooth dimensions are determined.*

F: Les points de mesure : voici comment les dimensions des dents sont déterminées.* **ES:** Puntos de medición: así se determinan las dimensiones de los dientes * **I:** Punti di misura: così si determinano le dimensioni del dente.*

> Anterior


Antérieure | Anteriores | Anteriori

Upper jaw and lower jaw

F: Maxillaire et mandibule



ES: Maxilar superior y maxilar inferior

I: Superiori e inferiori

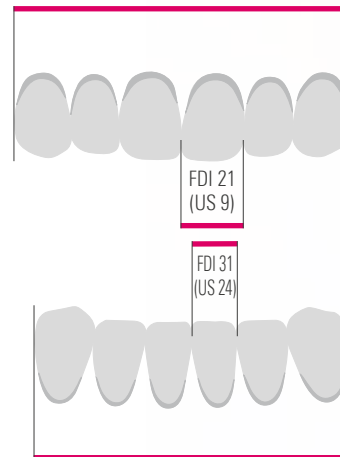

Tooth neck not included in measurement

Collet non mesuré | No se ha incluido el cuello dental en la medición | Il colletto non rientra nella misurazione



VITAPAN EXCELL

VITA PHYSIODENS

VITAPAN

VITA MFT

VITA VIONIC FRAME

VITA VIONIC VIGO

> Posterior


Postérieure | Posteriores | Posteriori

Upper jaw and lower jaw

F: Maxillaire et mandibule

ES: Maxilar superior y maxilar inferior

I: Superiori e inferiori

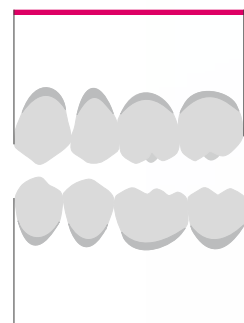

* All values in mm. Maximum deviation of measurements of denture teeth $\pm 5\%$ in accordance with DIN ISO 22112:2017







F: * Toutes les données en mm. Écart maximal des mesures des dents en résine $\pm 5\%$ selon DIN ISO 22112:2017

ES: * Todos los datos en mm. Diferencia máxima de las dimensiones de los dientes de resina $\pm 5\%$ según ISO 22112:2017

I: * Tutte le indicazioni in mm. Deviazione massima delle misure di denti protesici $\pm 5\%$ lt. DIN ISO 22112:2017

Upper Anteriors | Antérieures maxillaires | Anteriores superiores | Anteriori superiori



Ovoid
Ovale
Forma de pala
Ovale

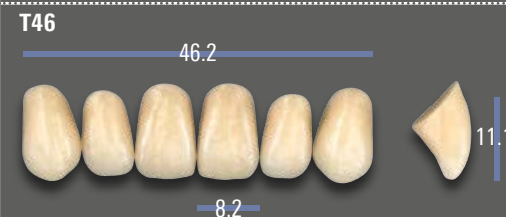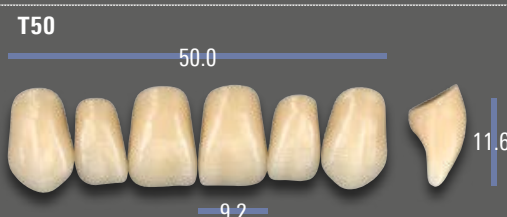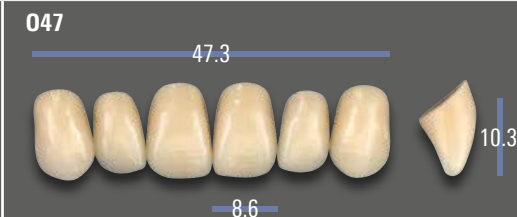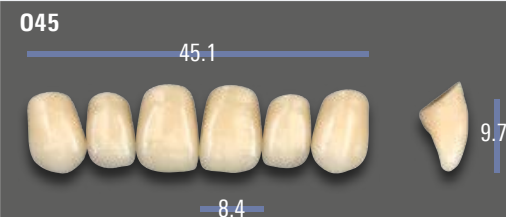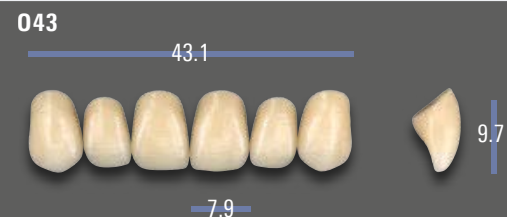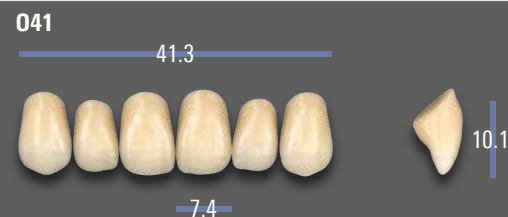

Triangular
Triangulaire
Triangular
Triangolare



Rectangular
Rectangulaire
Rectangular
Rettangolare

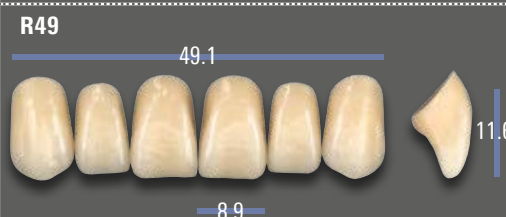



Square
Carrée
Cuadrado
Quadrato

S46

46.3



8.5



10.3

S48

47.9



8.7




9.1

S52

52.1



9.6



10.7

Lower Anteriors | Antérieures mandibulaires | Anteriores inferiores | Anteriori inferiori

L33

33.2



5.0



9.0

L35

35.3



5.2



9.9

L37

37.3



5.5



9.4

L37LC

37.4



5.6



11.4

L39

39.0



6.0



9.8

L41

41.2



6.1



10.8

► **Note: For VITAPAN LINGOFORM moulds, please select the appropriate register**

F: Remarque: pour les formes VITAPAN LINGOFORM, veuillez sélectionner le registre adapté

ES: Nota: seleccione el registro adecuado para las formas VITAPAN LINGOFORM

I: Avvertenza: per le forme VITAPAN LINGOFORM selezionare l'apposito registro

VITAPAN
EXCELL

VITAPAN
LINGOFORM

VITA
PHYSIODENS

VITAPAN









VITAPAN
CUSPIFORM

VITAPAN
SYNOFORM

VITA
MFT

VITA VIONIC
VIGO

VITA VIONIC
FRAME

VITAPAN EXCELL Anterior Antérieures Anteriores Anteriori	UJ / No.  mm	041 41.3	043 43.1	045 45.1	047 47.3	048 48.1	049 49.1	051 51.4								
	LJ / No.  mm	L33 33.2	L33 33.2	L35 35.3	L37 37.3	L37 / L37LC 37.3 / 37.4	L39 39.0	L41 41.2	L42 42.0	L44 44.1	L46 46.2	L47 46.9	L48 48.1	L50 50.0	L51 51.4	L54 54.4
VITAPAN LINGOFORM Posterior Postérieures Posteriores Posteriori	UJ / No.  mm	21L 30.1	21L 30.1	22L 31.6	22L 31.6	22L 31.6	23L 34.2	24L 35.8	21L 30.1	21L 30.1	22L 31.6	22L 31.6	22L 31.6	24L 35.8	23L 34.2	24L 35.8
	LJ / No.  mm	21L 30.7	21L 30.7	22L 32.1	22L 32.1	22L 32.1	23L 34.8	24L 36.4	21L 30.7	21L 30.7	22L 32.1	22L 32.1	22L 32.1	24L 36.4	23L 34.8	24L 36.4
VITAPAN EXCELL Anterior Antérieures Anteriores Anteriori	UJ / No.  mm	R45 45.4	R47 47.0	R49 49.1				S46 46.3	S48 47.9	S52 52.1						
	LJ / No.  mm	L35 35.3	L37 37.3	L39 39.0				L35 35.3	L37 37.3	L41 41.2						
VITAPAN LINGOFORM Posterior Postérieures Posteriores Posteriori	UJ / No.  mm	22L 31.6	22L 31.6	23L 34.2				22L 31.6	22L 31.6	23L 34.2						
	LJ / No.  mm	22L 32.1	22L 32.1	23L 34.8				22L 32.1	22L 32.1	23L 34.8						

The information contained in the combination table is only intended as a guide.

F: Les données fournies dans le tableau de correspondance ne sont donnés qu'à titre indicatif.

ES: Las informaciones recogidas en la tabla de combinaciones solo pueden verse como indicaciones aproximadas.

I: Le informazioni riportate nella tabella delle combinazioni sono da intendersi solamente come guida.



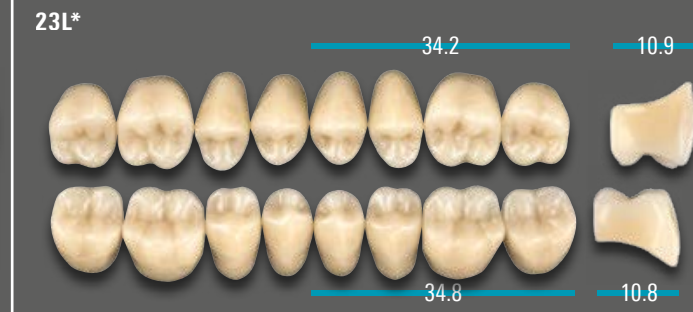
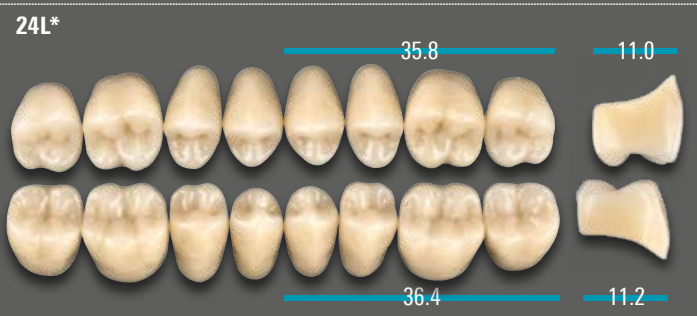
► **Note: For VITAPAN LINGOFORM moulds, please select the appropriate register**

F: Remarque: pour les formes VITAPAN LINGOFORM, veuillez sélectionner le registre adapté

ES: Nota: seleccione el registro adecuado para las formas VITAPAN LINGOFORM

I: Avvertenza: per le forme VITAPAN LINGOFORM selezionare l'apposito registro

Posterior | Postérieures | Posteriores| Posteriori
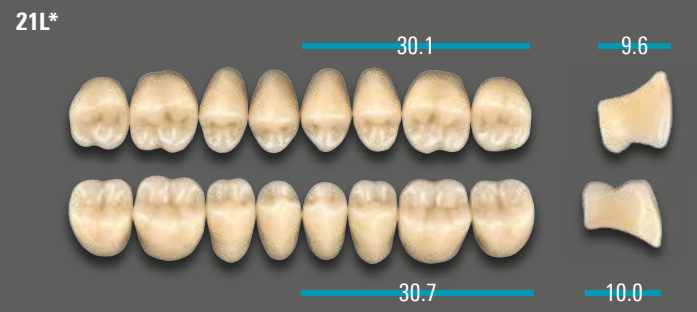
<p>21L*</p>  <p>30.1 9.6</p> <p>30.7 10.0</p>	<p>22L*</p>  <p>31.6 10.0</p> <p>32.1 10.2</p>	<p>23L*</p>  <p>34.2 10.9</p> <p>34.8 10.8</p>
<p>24L*</p>  <p>35.8 11.0</p> <p>36.4 11.2</p>		

Upper Anteriors | Antérieures maxillaires | Anteriores superiores | Anteriori superiori


Ovoid
Ovale
Forma de pala
Ovale

01S* 	02L 	03M 	04L
05L 	06L 		
T6S** 	T2S* 	T1S 	T3M
T4M* 	T5M 	T6L 	T7M
T8L* 	T9L 		



Triangular
Triangulaire
Triangular
Triangolare



Rectangular
Rectangulaire
Rectangular
Rettangolare

X1M*

46.3



8.8



11.0

X2L

46.2



8.7



11.6

X3L

47.8



9.0



11.8



Square
Carrée
Cuadrado
Quadrato

Z1S

44.1



8.1



9.8

Z2S

47.5



8.7



10.1

Lower Anteriors | Antérieures mandibulaires | Anteriores inferiores | Anteriori inferiori

L1S*

33.0



4.9



8.8

L2M*

34.5



5.2



10.4

L3M*

36.3



5.2



10.5

L4M*

35.5



5.4



9.4

L5M*

37.0



5.5



10.4

L6L

38.2



5.8



11.4

L7L

38.2



5.5



L8L

43.5



6.3



13.0

* Bleached shade(s) OM1 and OM3 available exclusively for selected mould(s).

** Mould(s) only available in VITA SYSTEM 3D-MASTER shade(s).

F: *Couleurs éclaircies OM1 et OM3 disponibles exclusivement pour la ou les formes choisies.

** Formes uniquement disponibles dans la ou les couleurs VITA SYSTEM 3D-MASTER.

ES: *Los colores blanqueados OM1 y OM3 están disponibles exclusivamente para formas seleccionadas.

** Forma(s) solo disponible(s) en los colores VITA SYSTEM 3D-MASTER

I: *I colori Bleached OM1 e OM3 sono disponibili esclusivamente in forme selezionate.

** Forme disponibili solo in colori VITA SYSTEM 3D-MASTER.

VITAPAN
EXCELL

VITAPAN
LINGOFORM

VITA
PHYSIODENS

VITAPAN

VITAPAN
CUSPIFORM

VITAPAN
SYNOFORM

VITA
MFT

VITA VIONIC
VIGO

VITA VIONIC
FRAME

VITA PHYSIODENS Anterior Antérieures Anteriores Anteriori	UJ / No.  mm	01S 42.3	02L 45.7	03M 47.2	04L 49.2	05L 50.1	06L 51.3	T6S 41.0	T2S 44.9	T1S 45.3	T3M 45.6	T4M 45.6	T5M 46.2	T6L 47.3	T7M 47.5	T8L 49.0	T9L 49.6
	LJ / No.  mm	L1S 33.0	L2M 34.5	L3M 36.3	L6L 38.2	L6L 38.2	L8L 43.5	L1S 33.0	L2M 34.5	L1S 33.0	L3M 36.3	L4M 35.5	L3M 36.3	L5M 37.0	L7L 38.2	L5M 37.0	L6L 38.2
VITA PHYSIODENS Posterior Postérieures Posteriores Posteriori	UJ / No.  mm	21E 30.5	22E 32.9	23E 33.5	24E 34.8	24E 34.8	25E 36.7	21E 30.5	21E 30.5	20E 29.4	22E 32.9	22E 32.9	23E 33.5	23E 33.5	23E 33.5	24E 34.8	25E 36.7
	LJ / No.  mm	21E 32.7	22E 33.7	23E 34.6	24E 36.1	24E 36.1	25E 37.3	21E 32.7	21E 32.7	20E 31.0	22E 33.7	22E 33.7	23E 34.6	23E 34.6	23E 34.6	24E 36.1	25E 37.3

VITA PHYSIODENS Anterior Antérieures Anteriores Anteriori	UJ / No.  mm	X1M 46.3	X2L 46.2	X3L 47.8	Z1S 44.1	Z2S 47.5
	LJ / No.  mm	L3M 36.3	L4M 35.5	L5M 37.0	L1S 33.0	L5M 37.0
VITA PHYSIODENS Posterior Postérieures Posteriores Posteriori	UJ / No.  mm	23E 33.5	23E 33.5	24E 34.8	21E 30.5	22E 32.9
	LJ / No.  mm	23E 34.6	23E 34.6	24E 36.1	21E 32.7	22E 33.7

The information contained in the combination table is only intended as a guide.

F: Les données fournies dans le tableau de correspondance ne sont donnés qu'à titre indicatif.

ES: Las informaciones recogidas en la tabla de combinaciones solo pueden verse como indicaciones aproximadas.

I: Le informazioni riportate nella tabella delle combinazioni sono da intendersi solamente come guida.

Posterior | Postérieures | Posteriores| Posteriori

<p>20E</p> <p>29.4 8.9</p> <p>31.0 8.3</p>	<p>21E*</p> <p>30.5 9.5</p> <p>32.7 8.7</p>	<p>22E*</p> <p>32.9 9.5</p> <p>33.7 9.0</p>
<p>23E*</p> <p>33.5 11.1</p> <p>34.6 9.8</p>	<p>24E*</p> <p>34.8 11.8</p> <p>36.1 9.8</p>	<p>25E</p> <p>36.7 11.2</p> <p>37.3 9.5</p>

* Bleached shade 0M3 available exclusively for selected mould(s).

F: * Couleur éclaircie 0M3 disponible exclusivement pour la ou les formes déterminées.

ES: * El color blanqueado 0M3 está disponible exclusivamente para formas seleccionadas.

I: * Il colore Bleached 0M3 è disponibile esclusivamente in forme selezionate


VITAPAN®

shades | couleurs | colores | colori:

28 x VITA SYSTEM 3D-MASTER® (0M1, 0M3, 1M1 – 5M3),

15 x VITA classical A1–D4® (A1, A2, A3, A3.5, A4, B2, B3, B4, C1, C2, C3, C4, D2, D3, D4)

Upper Anteriors | Antérieures maxillaires | Anteriores superiores | Anteriori superiori



<p>013</p> <p>41.7</p> <p>7.9</p> <p>9.5</p>	<p>025</p> <p>42.8</p> <p>8.1</p> <p>9.9</p>	<p>034</p> <p>43.3</p> <p>8.0</p> <p>9.7</p>	<p>035</p> <p>43.2</p> <p>8.0</p> <p>9.8</p>
<p>043</p> <p>43.6</p> <p>8.2</p> <p>9.4</p>	<p>086</p> <p>47.1</p> <p>8.9</p> <p>9.9</p>	<p>097</p> <p>49.2</p> <p>9.0</p> <p>11.5</p>	<p>098*</p> <p>48.1</p> <p>9.0</p> <p>11.8</p>
<p>099</p> <p>52.5</p> <p>9.8</p> <p>12.5</p>			



<p>T36*</p> <p>43.7</p> <p>8.1</p> <p>10.1</p>	<p>T53</p> <p>44.6</p> <p>8.1</p> <p>9.2</p>	<p>T56</p> <p>44.4</p> <p>8.3</p> <p>10.0</p>	<p>T66</p> <p>44.6</p> <p>8.3</p> <p>10.2</p>
<p>T67</p> <p>45.1</p> <p>8.4</p> <p>10.0</p>	<p>T76*</p> <p>45.9</p> <p>8.2</p> <p>10.4</p>	<p>T77*</p> <p>46.2</p> <p>8.5</p> <p>10.6</p>	<p>T88*</p> <p>47.1</p> <p>8.7</p> <p>10.6</p>




Rectangular
Rectangulaire
Rectangular
Rettangolare




Square
Carrée
Cuadrado
Quadrato


T98

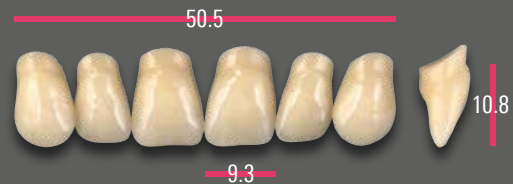


T99

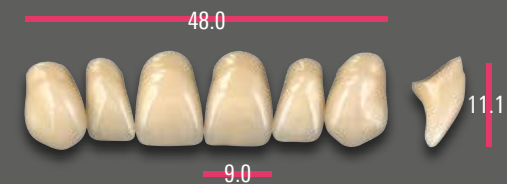


X13

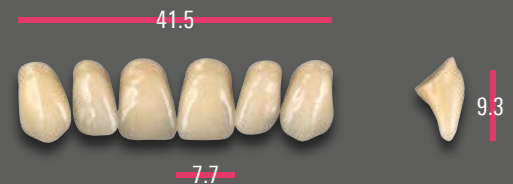


X66

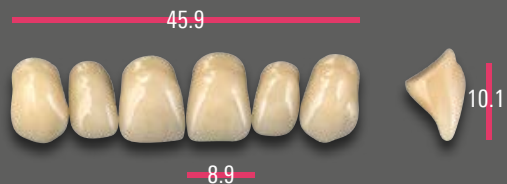


X77

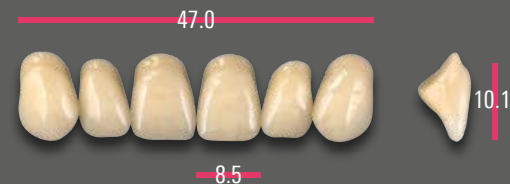


X87

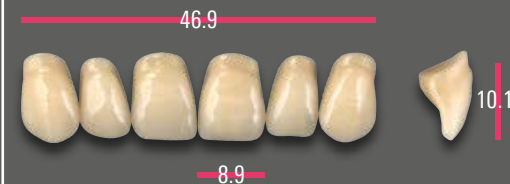

X96

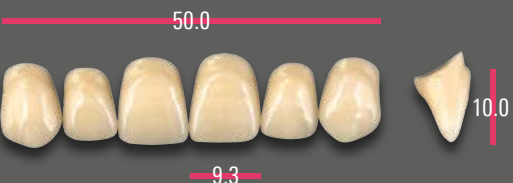


X99

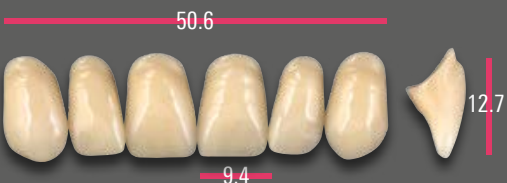


Z51




Z61

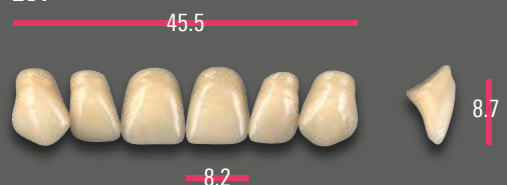


Z74

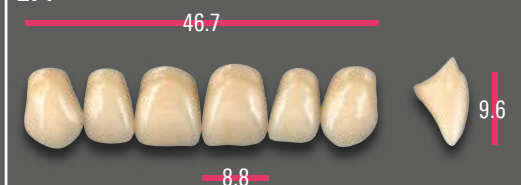

Z84

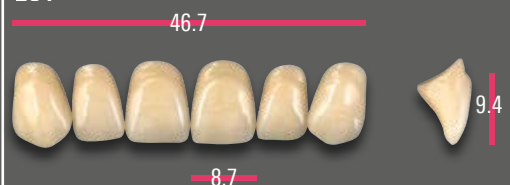

Z85

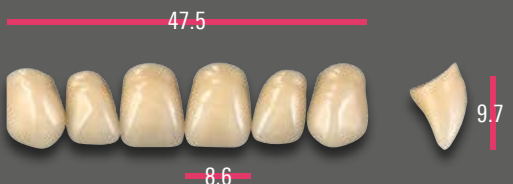

Z97



VITAPAN
EXCELL

VITAPAN
LINGOFORM

VITA
PHYSIODENS

VITAPAN

VITAPAN
CUSPIFORM

VITAPAN
SYNOFORM

VITA
MFT

VITA VIONIC
VIGO

VITA VIONIC
FRAME

VITAPAN®

shades | couleurs | colores | colori:

28 x VITA SYSTEM 3D-MASTER® (0M1, 0M3, 1M1 – 5M3),

15 x VITA classical A1–D4® (A1, A2, A3, A3.5, A4, B2, B3, B4, C1, C2, C3, C4, D2, D3, D4)

Lower Anteriors | Antérieures mandibulaires | Anteriores inferiores | Anteriori inferiori







Fully anatomical incisal edges F: Bords incisifs entièrement formés ES: Bordes incisales íntegros I: Bordi incisali integralmente configurati	L3 	L5* 	L5L 	L7*
	L9 	L11* 	L13 	L15
	L4* 	L8 	L10 	L12
	L14 			







* Bleached shade(s) 0M1 and 0M3 available exclusively for selected mould(s).

F: *Couleurs éclaircies 0M1 et 0M3 disponibles exclusivement pour la ou les formes choisies.

ES: * Los colores blanqueados 0M1 y 0M3 están disponibles exclusivamente para formas seleccionadas.

I: * I colori Bleached 0M1 e 0M3 sono disponibili esclusivamente in forme selezionate.

VITAPAN Anterior Antérieures Anteriores Anteriori	UJ / No.  mm	013 41.7	025 42.8	034 43.3	035 43.2	043 43.6	086 47.1	097 49.2	098 48.1	099 52.5	T36 43.7	T53 44.6	T56 44.4	T66 44.6	T67 45.1	T76 45.9	T77 46.2	T88 47.1	T98 50.5	T99 48.0
	LJ / No.  mm	L4 32.7	L3 33.4	L3 33.4	L3 33.4	L5 35.3	L11 36.9	L8 38.9	L13 37.0	L14 41.7	L4 32.7	L5 35.3	L5 35.3	L5 35.3	L4 32.7	L7 36.2	L11 36.9	L11 36.9	L15 38.0	L11 36.9
VITAPAN CUSPIFORM Posterior Postérieures Posteriores Posteriori	UJ / No.  mm	40C 28.1	40C 28.1	41C 29.9	41C 29.9	41C 29.9	42C 31.7	44C 32.8	42C 31.7	45C 34.8	40C 28.1	41C 29.9	41C 29.9	42C 31.7	42C 31.7	42C 31.7	42C 31.7	44C 32.8	45C 34.8	44C 32.8
	LJ / No.  mm	40C 29.5	40C 29.5	41C 31.3	41C 31.3	41C 31.3	42C 33.4	44C 34.6	42C 33.4	45C 36.3	40C 29.5	41C 31.3	41C 31.3	42C 33.4	42C 33.4	42C 33.4	42C 33.4	44C 34.6	45C 36.3	44C 34.6
VITAPAN SYNOFORM Posterior Postérieures Posteriores Posteriori	UJ / No.  mm	10S 29.0	10S 29.0	11S 30.0	11S 30.0	11S 30.0	12S 31.3	14S 33.1	12S 31.3	14S 33.1	10S 29.0	11S 30.0	11S 30.0	12S 31.3	12S 31.3	12S 31.3	12S 31.3	14S 33.1	14S 33.1	14S 33.1
	LJ / No.  mm	10S 30.5	10S 30.5	11S 31.9	11S 31.9	11S 31.9	12S 32.7	14S 35.4	12S 32.7	14S 35.4	10S 30.5	11S 31.9	11S 31.9	12S 32.7	12S 32.7	12S 32.7	12S 32.7	14S 35.4	14S 35.4	14S 35.4

VITAPAN Anterior Antérieures Anteriores Anteriori	UJ / No.  mm	X13 41.5	X66 45.9	X77 47.0	X87 46.9	X96 50.0	X99 50.6	Z51 44.6	Z61 45.5	Z74 46.7	Z84 46.7	Z85 47.5	Z97 52.2
	LJ / No.  mm	L4 32.7	L9 36.1	L11 36.9	L11 36.9	L10 39.0	L15 38.0	L3 33.4	L3 33.4	L9 36.1	L9 36.1	L13 37.0	L12 41.0
VITAPAN CUSPIFORM Posterior Postérieures Posteriores Posteriori	UJ / No.  mm	41C 29.9	42C 31.7	42C 31.7	44C 32.8	44C 32.8	45C 34.8	43C 31.0	43C 31.0	42C 31.7	42C 31.7	44C 32.8	45C 34.8
	LJ / No.  mm	41C 31.3	42C 33.4	42C 33.4	44C 34.6	44C 34.6	45C 36.3	43C 32.3	43C 32.3	42C 33.4	42C 33.4	44C 34.6	45C 36.3
VITAPAN SYNOFORM Posterior Postérieures Posteriores Posteriori	UJ / No.  mm	11S 30.0	12S 31.3	12S 31.3	14S 33.1	14S 33.1	14S 33.1	13S 31.3	13S 31.3	12S 31.3	12S 31.3	14S 33.1	14S 33.1
	LJ / No.  mm	11S 31.9	12S 32.7	12S 32.7	14S 35.4	14S 35.4	14S 35.4	13S 33.9	13S 33.9	12S 32.7	12S 32.7	14S 35.4	14S 35.4







The information contained in the combination table is only intended as a guide.

F: Les données fournies dans le tableau de correspondance ne sont donnés qu'à titre indicatif.

ES: Las informaciones recogidas en la tabla de combinaciones solo pueden verse como indicaciones aproximadas.

I: Le informazioni riportate nella tabella delle combinazioni sono da intendersi solamente come guida.

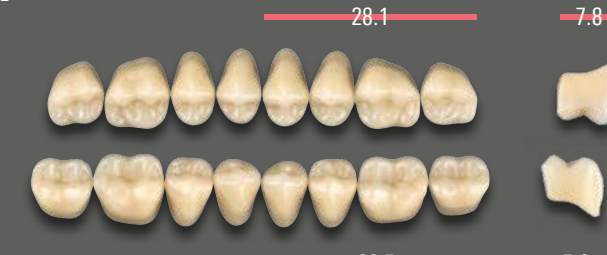Posterior | Postérieures | Posteriores | Posteriori
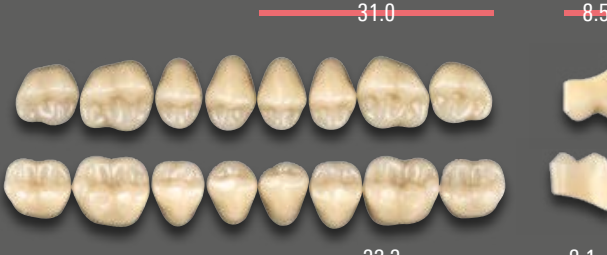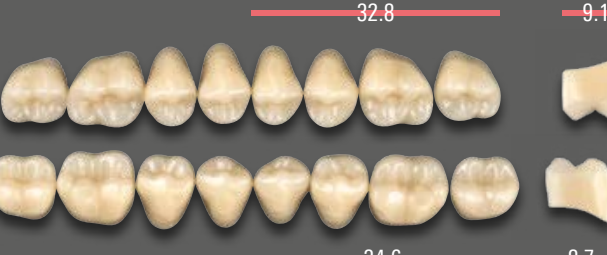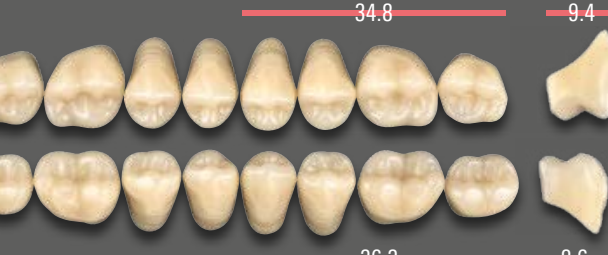
<p>40C</p> <p>28.1 7.8</p>  <p>29.5 7.6</p>	<p>41C*</p> <p>29.9 8.4</p>  <p>31.3 8.0</p>	<p>42C*</p> <p>31.7 8.3</p>  <p>33.4 8.0</p>
<p>43C</p> <p>31.0 8.5</p>  <p>32.3 8.1</p>	<p>44C*</p> <p>32.8 9.1</p>  <p>34.6 8.7</p>	<p>45C</p> <p>34.8 9.4</p>  <p>36.3 8.6</p>



* Bleached shade 0M3 available exclusively for selected mould(s).

F: * Couleur éclaircie 0M3 disponible exclusivement pour la ou les formes déterminées.

ES: * El color blanqueado 0M3 está disponible exclusivamente para formas seleccionadas.

I: * Il colore Bleached 0M3 è disponibile esclusivamente in forme selezionate

Posterior | Postérieures | Posteriores| Posteriori
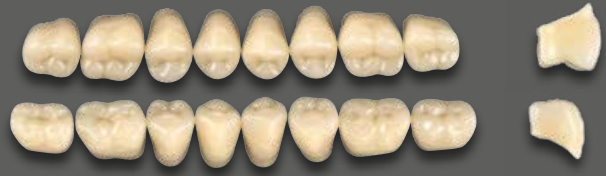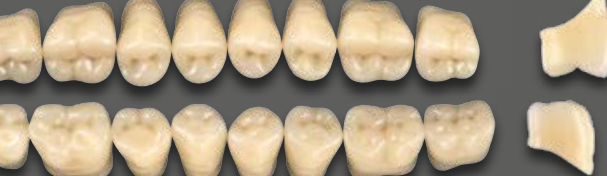
<p>10S</p> <p>29.0 7.5</p>  <p>30.5 6.8</p>	<p>11S</p> <p>30.0 7.8</p>  <p>31.9 7.3</p>	<p>12S</p> <p>31.1 8.7</p>  <p>32.7 7.8</p>
<p>13S</p> <p>31.3 8.3</p>  <p>33.9 7.4</p>	<p>14S</p> <p>33.1 9.3</p>  <p>35.4 8.3</p>	

Upper Anteriors | Antérieures maxillaires | Anteriores superiores | Anteriori superiori

 Ovoid Ovale Forma de pala Ovale	040  40.0 7.5 10.0	044  43.9 8.1 10.2	049  49.2 9.0 11.8
	T41  40.5 7.5 9.4	T43  43.3 8.2 10.3	T46  46.1 8.5 10.2
	R42  42.1 7.9 9.3	R45  44.5 8.2 10.3	R47  46.6 8.5 11.0
	S47  46.8 8.9 10.8	S50  49.7 9.2 12.0	
 Triangular Triangulaire Triangular Triangolare			T49  48.8 9.0 11.8
 Rectangular Rectangulaire Rectangular Rettangolare			
 Square Carrée Cuadrado Quadrato			


* The VITA MFT classical shades specified represent the closest possible approximation of VITA SYSTEM 3D-MASTER shades.

F: * Les couleurs VITA MFT classical indiquées s'approchent au mieux des couleurs VITA SYSTEM 3D-MASTER.





ES: * Los colores VITA MFT classical indicados constituyen la mejor aproximación posible a los colores VITA SYSTEM 3D-MASTER.

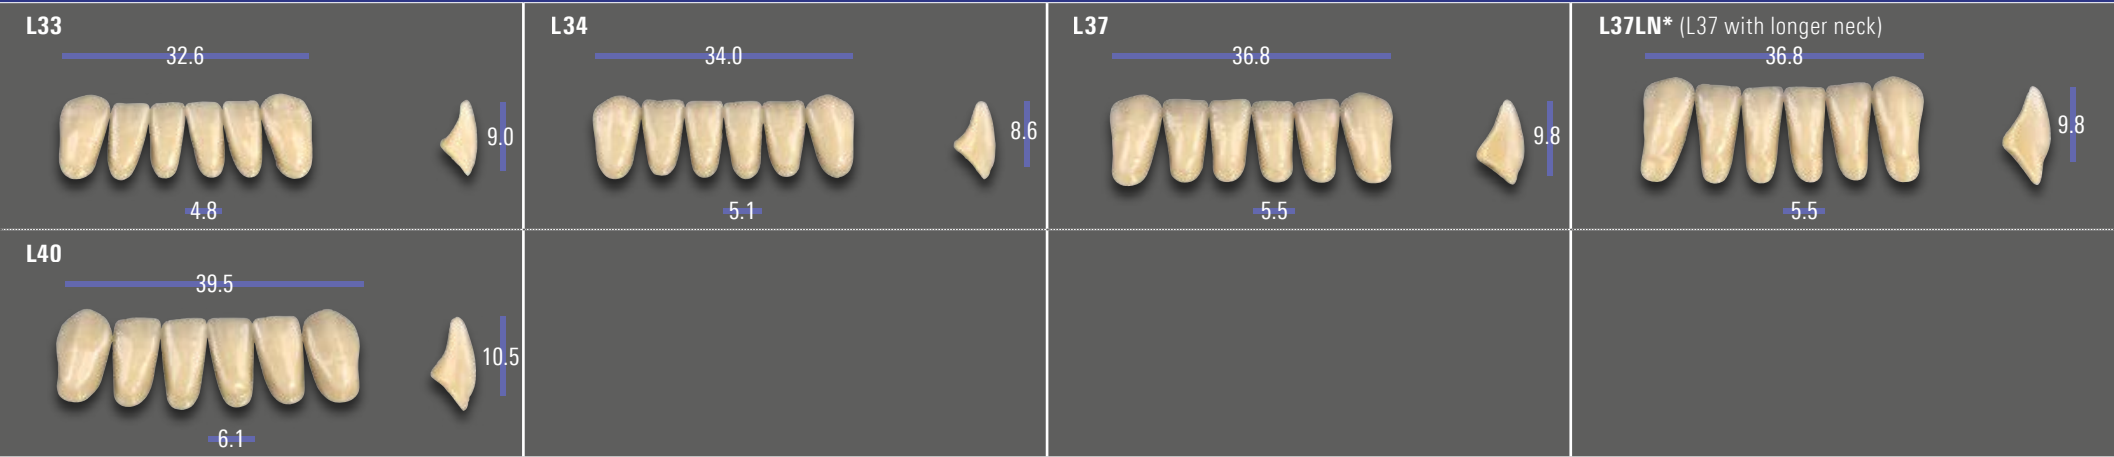I: * I colori VITA MFT classical indicati sono la migliore approssimazione ai colori VITA SYSTEM 3D-MASTER.

Lower Anteriors | Antérieures mandibulaires | Anteriores inferiores | Anteriori inferiori



* Long (047 or L37 with longer tooth neck) F: Longue (047 et L37 avec collet plus long) ES: Largo (047 o L37 con cuello más largo) I: Lungo (047 e L37 con colletto allungato)

VITA MFT Anterior Antérieures Anteriores Anteriori	UJ / No.  mm	040 40.0	044 43.9	049 49.2	T41 40.5	T43 43.3	T46 46.1	T49 48.8	R42 42.1	R45 44.5	R47 46.6	S47 46.8	S50 49.7
	LJ / No.  mm	L33 32.6	L34 34.0	L40 39.5	L33 32.6	L34 34.0	L37 36.8	L40 39.5	L34 34.0	L37 36.8	L37 36.8	L40 39.5	L40 39.5
VITA MFT Posterior Postérieures Posteriores Posteriori	UJ / No.  mm	PU29 28.8	PU29 28.8	PU33 33.0	PU29 28.8	PU31 30.6	PU31 30.6	PU33 33.0	PU29 28.8	PU31 30.6	PU33 33.0	PU33 33.0	PU33 33.0
	LJ / No.  mm	PL29 29.6	PL29 29.6	PL33 33.6	PL29 29.6	PL31 31.1	PL31 31.1	PL33 33.6	PL29 29.6	PL31 31.1	PL33 33.6	PL33 33.6	PL33 33.6

The information contained in the combination table is only intended as a guide.


F: Les données fournies dans le tableau de correspondance ne sont donnés qu'à titre indicatif.

ES: Las informaciones recogidas en la tabla de combinaciones solo pueden verse como indicaciones aproximadas.


I: Le informazioni riportate nella tabella delle combinazioni sono da intendersi solamente come guida.

Posterior | Postérieures | Posteriores | Posteriori


PU29 – PL29

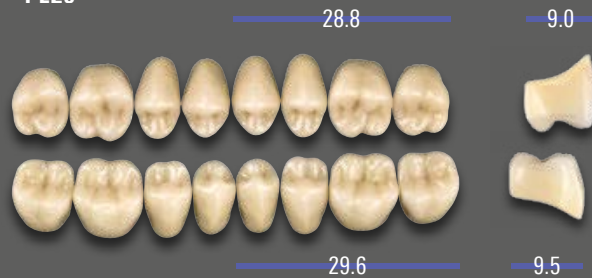

PU31 – PL31

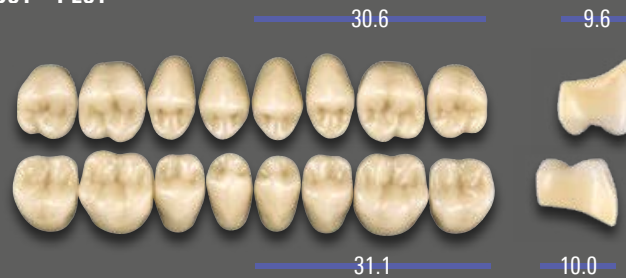

PU33 – PL33

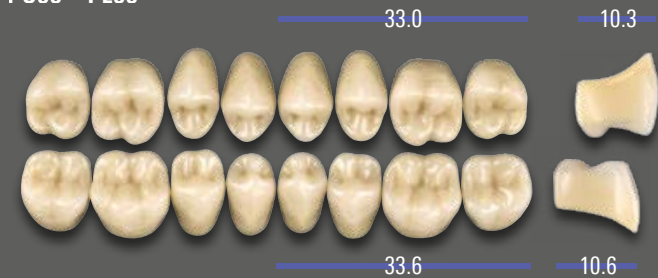

* The VITA MFT classical shades specified represent the closest possible approximation of VITA SYSTEM 3D-MASTER shades.

F: * Les couleurs VITA MFT classical indiquées s'approchent au mieux des couleurs VITA SYSTEM 3D-MASTER.

ES: * Los colores VITA MFT classical indicados constituyen la mejor aproximación posible a los colores VITA SYSTEM 3D-MASTER.

I: * I colori VITA MFT classical indicati sono la migliore approssimazione ai colori VITA SYSTEM 3D-MASTER.



VITAPAN
EXCELL

VITAPAN
LINGOFORM

VITA
PHYSIODENS

VITAPAN

VITAPAN
CUSPIFORM









VITAPAN
SYNOFORM

VITA
MFT



VITA VIONIC
VIGO

VITA VIONIC
FRAME

Upper Anteriors | Antérieures maxillaires | Anteriores superiores | Anteriori superiori

 Ovoid Ovale Forma de pala Ovale	043  43.3 7.9 10.7	045  44.8 8.3 11.3		
	T44  44.0 8.1 11.7	T46  46.2 8.2 11.6	T48  48.3 8.7 12.5	T50  49.9 9.2 12.9
	R47  47.0 8.6 10.7	R49  49.0 8.9 12.1		
 Triangular Triangulaire Triangular Triangolare				
 Rectangular Rectangulaire Rectangular Rettangolare				

Lower Anteriors | Antérieures mandibulaires | Anteriores inferiores | Anteriori inferiori

L33  33.2 4.9 8.9	L35  35.2 5.2 9.5	L37  37.2 5.5 10.0	L39  39.2 5.8 10.5
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Note: The VITA VIONIC VIGO prefabricated tooth is a specially developed product with a design perfected for digital production processes. The teeth are shortened in the cervical area and the contact surfaces to the denture base are preconditioned for bonding. As a result, the ready-to-use teeth that can be directly taken from the packaging and bonded into the cavities of the digitally fabricated denture base.

F: Remarque : la dent préfabriquée VITA VIONIC VIGO est un produit qui a été spécialement conçu pour les processus de production numérique. Les dents sont raccourcies au niveau cervical et les surfaces de contact avec la base prothétique sont préconditionnées pour le collage. Les dents prêtes à l'emploi peuvent donc être collées directement depuis l'emballage dans les cavités de la base prothétique fabriquée numériquement.

ES: Nota: el diente VITA VIONIC VIGO preconfeccionado es un producto desarrollado especialmente para procesos de confección digitales. Los dientes están recortados por cervical y se han preacondicionado las superficies de contacto para facilitar la adhesión a la base de la prótesis. De esta manera se pueden adherir los dientes listos para usar, directamente del embalaje, a las cavidades de la base de la prótesis confeccionada digitalmente.

I: Avvertenza: VITA VIONIC VIGO sono denti protesici sviluppati specialmente per il processo di produzione digitale. La zona cervicale è accorciata e le superfici di contatto con la base protesica preconditionate per l'incollaggio. I denti pronti per l'uso possono essere prelevati direttamente dalla confezione e incollati nelle cavità della base protesica realizzata in modalità digitale.

Posterior | Postérieures | Posteriores | Posteriori



VITA VIONIC VIGO Anterior Antérieures Anteriores Anteriori	UJ / No. mm	R47 47.0	R49 49.0	O45 44.8	T50 49.9	T46 46.2	O43 43.3	T44 44.0	T48 48.3
	LJ / No. mm	L37 37.2	L39 39.2	L35 35.2	L39 39.2	L37 37.2	L33 33.2	L33 33.2	L37 37.2
VITA VIONIC VIGO Posterior Postérieures Posteriores Posteriori	UJ / No. mm	22L 31.8	23L 34.3	22L 31.8	24L 35.9	22L 31.8	21L 30.3	21L 30.3	22L 31.8
	LJ / No. mm	22L 32.6	23L 35.0	22L 32.6	24L 36.9	22L 32.6	21L 31.0	21L 31.0	22L 32.6




► **Note:** The VITA VIONIC VIGO prefabricated tooth is a specially developed product with a design perfected for digital production processes. The teeth are shortened in the cervical area and the contact surfaces to the denture base are preconditioned for bonding. As a result, the ready-to-use teeth that can be directly taken from the packaging and bonded into the cavities of the digitally fabricated denture base.

F: Remarque : la dent préfabriquée VITA VIONIC VIGO est un produit qui a été spécialement conçu pour les processus de production numérique. Les dents sont raccourcies au niveau cervical et les surfaces de contact avec la base prothétique sont préconditionnées pour le collage. Les dents prêtes à l'emploi peuvent donc être collées directement depuis l'emballage dans les cavités de la base prothétique fabriquée numériquement.



ES: Nota: el diente VITA VIONIC VIGO preconfeccionado es un producto desarrollado especialmente para procesos de confección digitales. Los dientes están recortados por cervical y se han preacondicionado las superficies de contacto para facilitar la adhesión a la base de la prótesis. De esta manera se pueden adherir los dientes listos para usar, directamente del embalaje, a las cavidades de la base de la prótesis confeccionada digitalmente.

I: Avvertenza: VITA VIONIC VIGO sono denti protesici sviluppati specialmente per il processo di produzione digitale. La zona cervicale è accorciata e le superfici di contatto con la base protesica precondizionate per l'incollaggio. I denti pronti per l'uso possono essere prelevati direttamente dalla confezione e incollati nelle cavità della base protesica realizzata in modalità digitale.

Upper Anteriors | Antérieures maxillaires | Anteriores superiores | Anteriori superiori

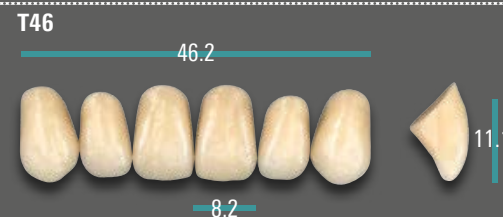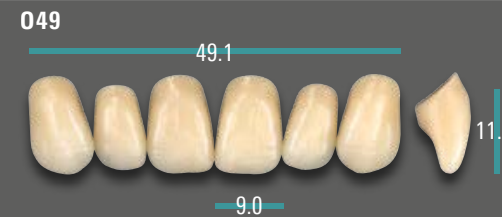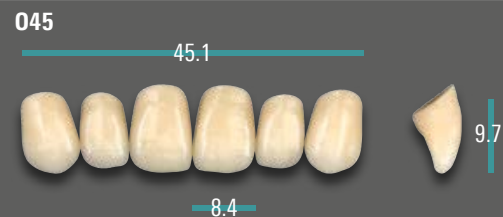

Lower Anteriors | Antérieures mandibulaires | Anteriores inferiores | Anteriori inferiori

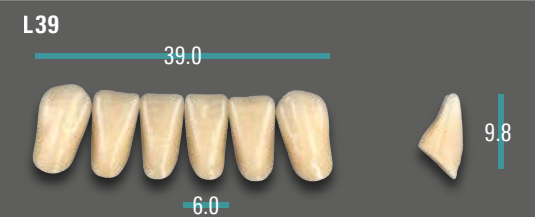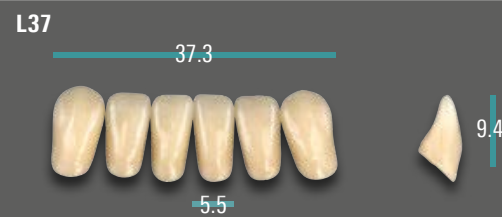





VITAPAN®LINGOFORM DD FRAME

shades | couleurs | colores | colori:

6 x VITA classical A1–D4® (A1, A2, A3, A3.5, B3, D3)

Posterior | Postérieures | Posteriores| Posteriori



VITAPAN EXCELL Anterior Antérieures Anteriores Anteriori	UJ / No.  mm	043 43.1	045 45.1	049 49.1	T44 44.1	T46 46.2	T48 48.1	T50 50.0	R45 45.4	R47 47.0
	LJ / No.  mm	L33 33.2	L35 35.3	L39 39.0	L33 33.2	L35 35.3	L37 37.3	L39 39.0	L35 35.3	L37 37.3
VITAPAN LINGOFORM Posterior Postérieures Posteriores Posteriori	UJ / No.  mm	21L 30.1	22L 31.6	23L 34.2	21L 30.1	22L 31.6	22L 31.6	24L 35.8	22L 31.6	22L 31.6
	LJ / No.  mm	21L 30.7	22L 32.1	23L 34.8	21L 30.7	22L 32.1	22L 32.1	24L 36.4	22L 32.1	22L 32.1

VITAPAN
EXCELL

VITAPAN
LINGOFORM

VITA
PHYSIODENS

VITAPAN

VITAPAN
CUSPIFORM

VITAPAN
SYNOFORM

VITA
MFT

VITA VIONIC
VIGO

VITA VIONIC
FRAME

More information on VITA PROSTHETIC SOLUTIONS is available at:

F: Vous trouverez de plus amples informations sur les SOLUTIONS PROTHÉTIQUES VITA sous:

ES: Encontrará información adicional sobre las SOLUCIONES PROSTODÓNTICAS DE VITA en:

I: Per ulteriori informazioni sulle SOLUZIONI PROTETICHE VITA consultare:

www.vita-zahnfabrik.com/prosthetic

E:

Please note: Our products must be used in accordance with the instructions for use. We accept no liability for any damage resulting from incorrect handling or usage. The user is furthermore obliged to check the product before use with regard to its suitability for the intended area of applications. We cannot accept any liability if the product is used in conjunction with materials and equipment from other manufacturers that are not compatible or not authorized for use with our product and this results in damage. The VITA Modulbox is not necessarily a component of the product. Date of issue of this information: 2023-08

After the publication of this information for use any previous versions become obsolete. The current version can be found at www.vita-zahnfabrik.com

VITA Zahnfabrik has been certified and the following products bear the mark:

CE 0124

VITAPAN® product range, VITA PHYSIODENS®, VITA MFT®, VITA VIONIC® product range

MD

F:

N.B. Nos produits doivent être mis en œuvre selon le mode d'emploi. Notre responsabilité n'est pas engagée pour les dommages résultant d'une manipulation ou d'une mise en œuvre incorrectes. En outre, l'utilisateur est tenu de vérifier, avant utilisation, que le produit est approprié à l'usage prévu. Notre responsabilité ne peut être engagée si le produit est mis en œuvre avec des matériaux et des appareils d'autres marques, non adaptés ou non autorisés et qu'il en résulte un dommage. Le VITA Modulbox n'est pas un composant obligatoire du produit. Date d'édition : 2023-08

Cette nouvelle édition de notice rend caduque toutes les versions antérieures. La version la plus récente se trouve toujours sur le site www.vita-zahnfabrik.com

VITA Zahnfabrik est certifiée et les produits suivants portent le marquage :

CE 0124

Gamme de produits VITAPAN®, VITA PHYSIODENS®, VITA MFT®, gamme de produits VITA VIONIC®

MD

ES:

Nota importante: nuestros productos deben utilizarse con arreglo a las instrucciones de uso. Declinamos cualquier responsabilidad por daños derivados de la manipulación o el tratamiento incorrectos. El usuario deberá comprobar, además, la idoneidad del producto para el ámbito de aplicación previsto antes de su uso. Queda excluida cualquier responsabilidad por nuestra parte por daños derivados a la utilización del producto en una combinación incompatible o no admisible con materiales o aparatos de otros fabricantes. La caja modular de VITA no es necesariamente parte integrante del producto. Publicación de estas instrucciones de uso: 2023-08

Con la publicación de estas instrucciones de uso pierden su validez todas las ediciones anteriores. La versión actual puede consultarse en www.vita-zahnfabrik.com

La empresa VITA Zahnfabrik está certificada y los siguientes productos llevan el marcado:

CE 0124

Familia de productos VITAPAN®, VITA PHYSIODENS®, VITA MFT®, familia de productos VITA VIONIC®

MD

I:

Avvertenza: I nostri prodotti vanno utilizzati in conformità alle istruzioni d'uso. Non assumiamo responsabilità per danni che si verifichino in conseguenza di incompetenza nell'uso o nella lavorazione. L'utilizzatore è inoltre tenuto a verificare, prima dell'utilizzo, l'idoneità del prodotto per gli usi previsti. Escludiamo qualsiasi responsabilità se il prodotto viene utilizzato in combinazioni non compatibili o non consentite con materiali o apparecchiature di altri produttori e ne consegue un danno. La VITA Modulbox non è necessariamente parte integrante del prodotto. Data di questa informazione per l'uso: 2023-08

Con la pubblicazione di queste informazioni per l'uso tutte le versioni precedenti perdono validità. La versione attuale è disponibile nel sito www.vita-zahnfabrik.com

VITA Zahnfabrik è certificata e i seguenti prodotti sono marcati:

CE 0124

Linea di prodotti VITAPAN®, VITA PHYSIODENS®, VITA MFT®, Linea di prodotti VITA VIONIC®

MD

VITA PROSTHETIC SOLUTIONS

 **VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co.KG**

Spitalgasse 3
79713 Bad Säckingen
Germany

Phone: +49 7761 562-0
Hotline: +49 7761 562-222
E-mail: info@vita-zahnfabrik.com

www.vita-zahnfabrik.com



CE 0124

MD